microlife®

B6 Advanced Connect

衛部醫器陸輸字第 001335 號

百略醫學全自動電子血壓計

Microlife Automatic Blood Pressure Monitor

Microlife BP3KV1-5B (BP B6 Advanced Connect)

使用說明書

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用， 應遵守個人資料保護法之規範。」

準備

1.

請坐在有靠背的椅子上並保持雙腳平行。

2.
避免穿過厚的貼身衣物或是卷成短袖袖子。

3. 

請將壓脈帶上 "ARTERY" 的標籤對準您的血管位置。

4. 
壓脈帶適當地繫在手臂上，並請勿繫太緊。

5. 

請確認壓脈帶位於手肘上方約 2 公分位置。

6.
測量期間請勿移動手臂及說話。

1.

30 分鐘內避免進食，洗澡，抽菸及攝取含咖啡因食物。

2.

避免劇烈活動並先休息 5-10 分鐘。

3.

量測前服用藥物可能會影響血壓量測數值。

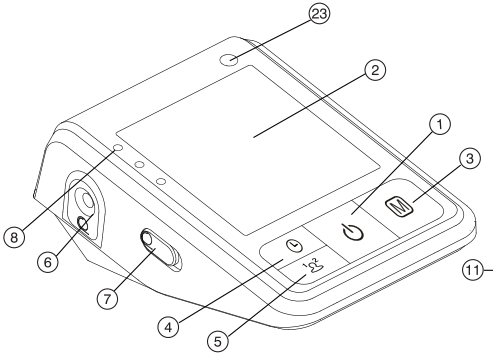
23
2
1
3
8
6
7
4
5

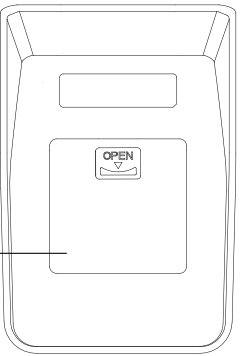
OPEN
11

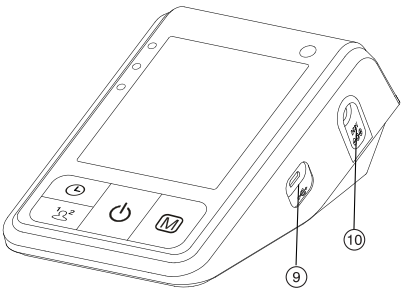
10
9

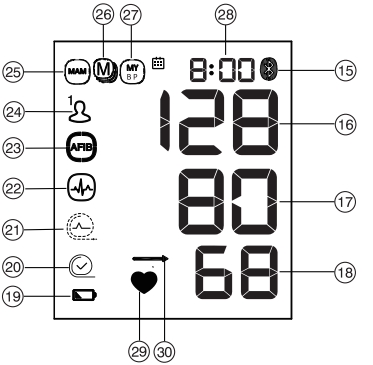
26
27
28
25
15
24
16
23
22
17
21
20
18
19
29
30
8:00
128
80
68
MAM
AFIB


12
13
14


20-A
20-B
20-C

① 開 / 關按鈕
② 顯示螢幕
③ 記憶按鍵
④ 藍牙 / 時間按鍵
⑤ 使用者切換鍵
⑥ 壓脈帶插座
⑦ MAM 切換鍵
⑧ 血壓等級指示
⑨ USB 傳輸埠
⑩ 變壓器插座
⑪ 電池蓋
⑫ 壓脈帶
⑬ 壓脈帶充氣管
⑭ 壓脈帶接頭 (ISO 接頭)

顯示螢幕

⑮ 藍牙指示
⑯ 收縮壓
⑰ 舒張壓
⑱ 脈搏
⑲ 電池電量指示
⑳ 壓脈帶穿戴確認指示
-A：壓脈帶配戴不佳提示
-B：手臂移動提示（Err2）
-C：壓脈帶壓力確認提示（Err3）
㉑ 壓脈帶訊號指示（Err1）
㉒ 心律不整顯示
㉓ 心房顫動顯示 (AFIB)
㉔ 使用者顯示
㉕ MAM 模式
㉖ 儲存數值
㉗ 臨床平均血壓值 «MyBP»
㉘ 日期 / 時間
㉙ 脈搏指示
㉚ 血壓走向指示 «MyCheck»

遵從使用說明。本文件提供關於本產品的重要產品操作與安全資訊。使用前請詳讀並妥善保存以備未來不時之需。

表示此產品為內部電源類BF型應用部份設備。

不防水，請保持乾燥。

產品適用範圍

本產品適用於測量 12 歲以上族群的非侵入性血壓。
本產品，適用高血壓、低血壓、糖尿病、懷孕、子癇前症、動脈粥狀硬化、末期腎病變、肥胖及老年患者。

本產品可偵測提示心房顫動 (AF, Atrial Fibrillation) 的不規則脈搏。
請注意，本產品並非用於診斷心房顫動。心房顫動的診斷只能透過心電圖（ECG）確診。建議患者經醫師診斷。

親愛的顧客 ：

如果您有任何疑問、問題或需要訂

購備用配件，請聯絡當地的客戶服務中心。您的經銷商或藥局會提供您當地經銷商地址。您也可以造訪 www.microlife.com，瀏覽產品相關資訊。

目錄

1. 心房顫動 (AFIB) 的偵測
- 甚麼是心房顫動？
- 誰需要做心房顫動的篩檢？
- 您可控制的風險因素

2. 第一次使用血壓計
- 使用合適的電池
- 設定日期和時間
- 選擇正確的壓脈帶
- 選擇使用者
- 選擇測量模式：標準或 MAM 模式

3. 如何正確的量測血壓

4. 進行血壓量測
- 手動充氣
- 如何讓量測結果不被儲存
- 我該如何評估我的血壓值？
- 血壓走向圖 «MyCheck»
- 心律不整偵測

5. 資料記憶
- 查看過去 28 天的平均值
- 臨床平均血壓值 «MyBP»
- 檢視儲存之單筆數值
- 清除所有資料

6. 電池電量指示和電池更換
- 電池電力不足
- 電池沒電 - 更換
- 電池類型及規格
- 使用可充電式電池

7. 使用變壓器

8. 藍牙 Bluetooth 功能

9. 電腦連接功能

10. 錯誤訊息

11. 安全性維護、準確度測試和丟棄處置
- 安全與保護
- 儀器保養
- 清潔壓脈帶
- 準確度測試
- 丟棄處置

12. 保固

13. 技術規格

1. 心房顫動 (AFIB) 的偵測及早期發現

本產品能夠檢測心房顫動（AFIB）。在標準（單次）或 MAM 模式下進行血壓量測，符號 (23) 顯示表示在測量過程中偵測到心房顫動。
有關該資訊，請參閱下一段內容並諮詢您的醫生。

給醫師的訊息：
本產品是透過示波法偵測血壓計，並能在量測過程中分析心律不整。
如果使用者在量測過程中出現心房顫動，則 AFIB 符號會在量測後顯示。
如果使用者在測量完整的血壓量測後出現 AFIB 符號，建議再進行另一次完整的血壓量測。如果 AFIB 符號再次出現，我們建議盡早尋求專業醫療諮詢。如果 AFIB 符號出現在顯示螢幕上，表示可能存在心房顫動。然而，心房顫動的診斷必須由專業醫師透過心電圖來做最終確認。

- ☞在測量過程中請保持手臂靜止，以避免誤判量測值。
- ☞對於心臟節律器或除顫器的病患，本產品可能無法或是錯誤地偵測到心房顫動。
- ☞在心房顫動的存在下，舒張壓的測量數值可能是不准確的。
- ☞在心房顫動的存在下，建議使用MAM模式提供更可靠的血壓測量。

甚麼是心房顫動 (AF)?
正常情況下，您的心臟收縮及放鬆是相當有規律的。心臟中的某一群細胞會產生電流訊號，引起心臟收縮並輸送血液。心房顫動的發生來自於快速且無序的電流訊號產生在心臟的兩個上腔室（心房），進而導致心房收縮不規律（這稱為顫動）。
心房顫動是心律不整最常見的一種。它通常不會引起任何明顯的症狀。然而，它會顯著增加中風的風險，您會需要與醫師協助您控制此問題。

誰需要做心房顫動的篩檢？
建議 65 歲以上的族群進行心房顫動的篩檢，因為隨著年齡增長，發生中風的機率會增加，也建議用在年齡 50 歲以上並有高血壓的族群（例如收縮壓高於 159 或舒張壓高於 99）、糖尿病族群、冠心病族群或是先前患有中風的人。
年輕族群或孕婦則不建議進行 AFIB 篩查心房顫動的篩檢，因為它可能會產生錯誤的結果和引起不必要的焦慮。此外與老年人相比，患有心房顫動的年輕族群發生風險也較低。

☞Microlife AFIBsens 技術提供心房顫動簡便篩檢方法。
了解自己的血壓以及自己或家人是否有心房顫動情況有助於降低中風的風險。
Microlife AFIBsens 技術提供測量血壓的同時篩檢心房顫動的簡便方法。

您可控制的風險因素
心房顫動的早期診斷和合適的治療可以顯著降低的中風的風險。瞭解您的血壓並瞭解您是否患有心房顫動是預防中風的第一步。
更多資訊請訪問網站：www.microlife.com/afib。

2. 第一次使用血壓計

使用合適的電池
使用血壓計前，應先裝置電池，電池蓋 ⑪ 位於血壓計的底部。將合適的電池（4 x 1.5 V, AA 電池）裝入電池槽後，即可開始設定血壓計。

設定日期和時間
1. 新電池裝好無誤後，顯示螢幕上的年份數字會閃動。可按 M 按鈕 ③ 來設定你需要的年份。確認年份後，接著按時間按鍵 ④ 來設定您需要的月份。
2. 按下 M 按鈕 ③ 來設定月份。確認月份後，接著按時間按鍵 ④ 來設定您需要的日期。
3. 請依照上述指示設定日期、小時和分鐘。
4. 設定分鐘並按時間按鍵 ④ 後，日期和時間便設定完成，並且會顯示時間。
5. 如果想要變更日期和時間，按住時間按鍵 ④ 約 3 秒鐘直到年份數字開始閃動。現在可依照上述步驟輸入新的數值。

⚠ 注意：確保本產品上的日期和時間設定正確。不正確的設定會使測量數據和時間記錄被誤導。

選擇正確的壓脈帶
Microlife 提供不同尺寸的壓脈帶，請依據您的上臂圍（以完全包覆上臂中央作為測量標準）選擇適當的壓脈帶尺寸。

壓脈帶尺寸	上臂圍
S	17-22 公分
M-L	22-42 公分
L-XL	32-52 公分

⚠ 注意：本產品僅能使用原廠的壓脈帶及壓脈帶接頭！

⚠ 注意：使用過大或過小尺寸的壓脈帶量測會造成量測結果不準確，請使用正確尺寸的壓脈帶量測以確保結果的準確度。

▶ 如果隨附的壓脈帶 ⑫ 不合適，請聯繫當地的 Microlife 服務中心。

將壓脈帶連接本產品

▶連接壓脈帶與本產品：將壓脈帶接頭 ⑭ 插入壓脈帶插座 ⑥ 直到完全插入。

⚠ 注意：請確保將壓脈帶接頭已牢固插入本產品的壓脈帶插座，完全插入時會聽到清晰的“喀”聲響才是確實安裝緊密。

☞ **提醒: 壓脈帶接頭未安裝緊密會導致量測結果不準確，並顯示錯誤訊息 (Err3)。**

選擇使用者

本產品可提供至多兩位使用者使用。

▶ 需要切換使用者 1 或使用者 2㉔ 時，按下使用者切換鍵 ⑤。

☞ 在每次量測前，請確保使用者是否已正確選擇。

選擇測量模式：標準或 MAM 模式

在每次測量之前，選擇標準（單次測量）或 MAM 模式（自動雙次測量）。在 MAM 模式下，血壓計將自動連續進行 2 次量測，然後自動分析並顯示結果。因為人體血壓是會持續變動的，以這種方式獲得的結果比起單次測量時更可靠。

- 欲選擇 MAM 模式，請按 MAM 按鈕 ⑦，直到顯示螢幕上出現 MAM 符號 ㉕。欲改為標準模式（單次測量），請再次按下 MAM 按鈕，直到 MAM 符號消失。
- 螢幕右下方的地方會顯示 1 或 2 代表目前測量的順序編號。
- 前後測量間有 15 秒的緩衝時間。倒數時間代表剩餘的時間。
- 個別的測量結果不會顯示。所有的量測次數都完成後才會顯示您的血壓數值。
- 在血壓量測期間，不要移動壓脈帶。
- 若其中一次測量誤差太大，血壓計會自動進行額外的測量。

3. 如何正確的量測血壓

1. 測量前請避免運動、飲食或抽煙。
2. 測量前請至少在有靠背的椅子上靜坐 5 分鐘並放鬆身體。保持雙腳平放在地板上，不要交叉雙腿。

3. 請務必同一手臂測量（一般為左手臂）。
4. 移除上臂的貼身衣物。為避免手臂緊縮，不應卷成短袖袖子，平整的衣袖並不會干擾壓脈帶的運作。
5. 請確認壓脈帶的正確位置（軟 / 硬壓脈帶上有提示）。
- 套牢壓脈帶，但不宜過緊。
- 請確認壓脈帶位於手肘以上 2 公分的位置。
- 壓脈帶上的 ARTERY MARK(動脈標誌)3 公分寬必須靠在手臂內側的動脈位置裡。
- 放鬆手臂。
- 請確認壓脈帶的高度與心臟同高。

4. 進行血壓量測

1. 選擇標準（單次測量）或 MAM 模式（自動二次測量）：詳細內容請參考章節《2.》。
2. 開始測量 : 按開 / 關按鈕 ①。
3. 壓脈帶會自動充氣。測量過程中請放鬆、不要移動或拉緊您的手臂肌肉直到測量結果顯示出來。正常呼吸，不要說話。
4. 顯示螢幕上顯示“壓脈帶穿戴確認指示 ⑳”表示壓脈帶穿戴正確。如果符號 ⑳-A 顯示，則表示壓脈帶配戴不理想，但仍然可以測量。
5. 當壓脈帶達到正確的壓力時，血壓計會停止充氣並且逐漸釋放壓力。如果未達到所需要的壓力，血壓計將自動充入更多的空氣到壓脈帶中。
6. 在測量過程中，脈搏指示 ㉙ 會閃爍顯示。
7. 測量結果的呈現，包括收縮壓 ⑯、舒張壓 ⑰、脈搏 ⑱ 。***請注意本手冊中顯示符號的說明。***
8. 完成測量後，取下壓脈帶。
9. 關閉血壓計。（本產品會在約 1 分鐘後進入待機狀態）。

☞ ***您可以隨時按下開 / 關按鈕來停止測量（例如您在測量過程中感覺到不舒適的壓力時。***

☞ 當孕婦測量到異常高的讀值時，你應該休息一下後再進行測量（例如 1 小時）。如果讀值仍然太高，請諮詢您的醫師。

手動充氣

在使用者有高收縮壓（例如高於 135mmHg）的情況下，可利用獨立設定充氣壓力值來完成測量。請在充氣達到約 30 mmHg（顯示於顯示螢幕上）時，按開 / 關按鈕。按住按鈕直到壓力比預期的收縮壓高出約 40 mmHg - 即可鬆開按鈕。

如何讓量測結果不被儲存

當測量數值一出現在顯示於顯示螢幕時，請快速按住開 / 關按鈕 ① 直到《M》㉖ 符號閃爍。確認要刪除測量數值，按下時間按鍵 ④。

☞ 刪除成功時，將會顯示《CL》於顯示螢幕上。

我該如何評估我的血壓值

血壓危險等級指示 ⑧：左側的燈號指示顯示您血壓值所屬的範圍。依燈號指示的顏色不同，測量讀值會落在正常（綠燈）、臨界（黃燈）或危險（紅燈）的範圍。

此分類法是參考國際指南（ESH，ESC，JSH）來定義。mmHg 為單位。

範圍		收縮壓	舒張壓	建議
1.	血壓過高	≥135	≥85	請尋求專業醫療建議
2.	血壓略高	130 - 134	80 - 84	自我檢測
3.	血壓正常	<130	<80	自我檢測

請以較高的數值來評估您的血壓。

例如 :140/80mmHg 或 130/90mmHg 代表《血壓過高》。

血壓走向指示 «MyCheck»

" 血壓走向指示 ㉚ " 將顯示最新的測量值，低於、高於或相同於存儲的平均值。(參閱《5. 資料記憶》)

- 測得的收縮壓與舒張壓，其中任一個數值高於存儲的平均值 5mmHg，箭頭將顯示向上。
- 測得的收縮壓與舒張壓，其中任一個數值低於存儲的平均值 5mmHg，箭頭將顯示向下。
- 測得的收縮壓與舒張壓相差不大，與存儲平均值相差在 5mmHg 以內，箭頭將顯示水平指向。
- 測得的收縮壓和舒張壓，比對存儲的平均值分別高於與低於 5mmHg，顯示螢幕首先將顯示收縮壓數值以及向上或向下箭頭，閃爍兩秒鐘。接著將顯示舒張壓的數值以及向上或向下箭頭，閃爍兩秒鐘。

心律不整偵測

心律不整的符號 ㉒ 出現表示測量過程中檢測到了不規則的脈搏。假如心律不整的符號出現時，建議使用 MAM 模式重覆量測確認血壓量測值，詳閱章節《2》。

☞ 當心房顫動被偵到時也會顯示心律不整的符號，因心房顫動也是心律不整的一類型。

5. 資料記憶

測量後，2 個用戶可各別存儲 99 個測量值。

按下使用者切換按鈕 ⑤，可以切換用戶 1 或 2。

臨床平均血壓值 «MyBP»

再次按下 M 按鈕 ③，可查看相關臨床平均血壓 «MyBP»。顯示螢幕將先顯示儲存數值 ㉖ 與臨床平均血壓值 «My BP»㉗。此顯示前提為具備最近 28 天內 12 個臨床測量有效數值 (如下規範) 的血壓平均值。

- ☞ 早上 05：00-10：59 以及晚上 17：00-22：59 之間執行的測量。
- ☞ 每天最多納入 4 個讀數 (早上 2 個，晚上 2 個)
- ☞ 在正確時間 (如前述規範) 執行血壓測量，不論標準模式或 MAM 模式下的，都可納入平均。
- ☞ 在 MAM 模式以及標準模式下測得的數值，都歸類為單一測量值，以便納入《My BP 平均血壓》。
- ☞" 壓脈帶配戴不佳提示 "⑳-A 下測量出的血壓數值，將不納入 MyBP 平均血壓的計算當中。

過去 28 天的平均血壓值

再次按下 M 按鈕 ③。顯示螢幕會先顯示《M》㉖ 及《28A》，此時顯示之數值為 28 天內儲存資料的平均值。

- ☞ 血壓測量結果如果出現 " 壓脈帶配戴不佳提示 "⑳-A，測量數值不納入平均值的計算當中。

檢視儲存資料

再次按下M- 按鈕將顯示前一筆測量資料。顯示螢幕會先顯示《M》㉖ 及一個數值，例如《M17》。

這代表記憶中共儲存 17 筆測量數值。再次按下 M 按鈕將顯示前一筆測量數值。重複按下 M- 按鈕則可查看再下一筆資料。

- ☞ ***請注意本產品的最大存儲容量為 99 筆測量資料。當 99 筆資料均已存滿時，最舊的資料會自動被第 100 筆資料覆蓋。***

清除所有資料

請先確認使用者。如果您確定要永久刪除所有的儲存資料，請在待機狀態下按住 M 按鈕 ③ 直到《CL ALL》出現後放開按鈕。接著在 "CL ALL" 閃爍時按時間按鈕 ④。本產品無法清除個別的測量資料。

- ☞ **取消刪除：**在《**CL ALL**》閃爍時按開 / 關按鈕 ①。

6. 電池電量指示和電池更換

電池電力不足

電池電量耗盡 3/4 時，本產品一啟動量測時便會閃爍低電壓電池符號

⑲(顯示僅有部分電量的電池)。雖然這時本產品還是可以測量，但您應該準備備用電池。

電池沒電 - 更換

電池沒電時，本產品一啟動量測時便會閃爍低電壓電池符號 ⑲(顯示無電量的電池)。這時無法再進行測量，必須更換電池。

1. 將本產品背面的電池蓋 ⑪ 打開，將新電池放入電池槽。
2. 更換電池 - 請務必依電池槽上的極性符號裝入電池。
3. 要設定日期和時間，請依照章節《2.》所述的程式操作。

☞ 雖然需重設日期和時間，但還是會保留所有被儲存的測量資料 - 更換電池後會自動閃爍顯示年份數位，請重新設定日期和時間。

電池類型及規格

☞ 請使用 4 顆全新長效型 1.5V 的 AA 鹼性電池。

☞ 請勿使用過期的電池。

☞ 若本產品久置不用，請取出電池。

使用可充電式電池

您也可以使用充電電池操作本產品。

☞ 僅可使用 “NiMH” 型可重複性電池。

☞ 當低電壓電池符號 ⑲(顯示無電量的電池) 出現，電池必須拆下並重新充電。不要把沒電的電池滯留在本產品內，因為電池可能會受損壞。

☞ 如果一周或更長時間不打算使用本產品，請務必取出充電電池。

☞ 電池無法在本產品量測血壓同時充電。使用外部充電器來充電並注意有關充電、保養及耐用性等訊息。

7. 使用變壓器

您可使用 Microlife 專用的變壓器 (DC 6V, 600 mA) 來操作本產品。

☞ ***請只使用 Microlife 變壓器。***

☞ ***請確認變壓器或接線沒有損壞。***

1. 請將變壓器接線端插入本產品的變壓器插座 ⑩ 中。
2. 請將變壓器插頭插入牆壁插座內。

當連接變壓器後，將不會損耗電池電量。

8. 藍牙 (Bluetooth) 功能

本產品的藍牙功能可與有安裝 <<Microlife Connected Health+ >>APP 的智慧行動裝置連結。(行動裝置作業系統 : Android OS 或 iOS)

有關更多詳細資訊，請造訪 http://www.microlife.com/technologies/connect
本軟體只搜集、儲存、顯示用於健康管理，不涉及疾病診斷。

藍牙操作

- 手動開啟藍牙：按下 藍牙 / 時間按鈕 ④ 啟動藍牙，顯示幕上的藍牙符號 ⑮ 將會閃爍。
- 自動開啟藍牙：藍牙將在測量後自動啟動。顯示幕上的藍牙符號 ⑮ 將會閃爍。
- 手動關閉藍牙：按開 / 關按鈕 ① 關閉藍牙。

藍牙連接與配對

1. 開啟智慧型手機上的「Microlife Connected Health+」應用程式（確保應用程式在前台運行，而不是在背景運行。）
2. 手動開啟藍牙，將裝置連接到智慧型手機。
3. 當智慧型手機找到裝置時，智慧型手機將顯示與裝置配對的訊息。在智慧型手機上確認以完成配對。取消以終止配對。
4. 配對後，應用程式將顯示一則訊息，要求選擇裝置使用者（1 或 2），會設定到應用程式的使用者檔案中。確認以繼續設定。取消以終止設定（如果使用者選擇不正確）。
5. 設定後，本產品將自動傳輸測量資料和日期 / 時間設定至應用程式。數據傳輸成功後，藍牙會自動關閉。

藍牙狀態

- 藍牙符號 ⑮ 緩慢閃爍：藍牙已啟動並等待連線。
- 藍牙符號 ⑮ 不閃爍：藍牙連線已建立。
- 藍牙符號 ⑮ 快速閃爍：藍牙連線錯誤。

☞ **如果藍牙連線錯誤，請關閉裝置藍牙，等待一分鐘，然後重新嘗試藍牙連線。參見章節 <<10. 錯誤訊息 >> 了解詳細資訊。**

9. 電腦連接功能

此本產品可被用在與電腦執行百略血壓分析軟體 (Blood Pressure Analyzer+) 做為連結。記憶體資料可藉由連接線傳送到電腦。可從網站 www.microlife.com 下載中文版軟體及使用標準 Micro-USB 線。(功能：傳輸 / 檢閱 / 保存 血壓資料)

10. 錯誤訊息

測量時若發生錯誤，測量便會中斷並顯示錯誤訊息，如“ERR3”

錯誤	說明	可能原因和解決方式
<Err1> ㉑	訊號太弱	壓脈帶的脈衝訊號太弱。請重新調整壓脈帶的位置再測量。*
<Err2> ⑳-B	錯誤訊號	在測量時，壓脈帶會偵測出因手臂移動或肌肉張力而產生的錯誤訊號。請再測量一次，手臂保持靜止狀態。
<Err3> ⑳ -C	壓脈帶充氣不正常 ⚠	壓脈帶內無法產生足夠的壓力，可能是有漏氣的情形，請檢查壓脈帶是否有緊密接好，必要時請更換電池，然後再測量一次。**注意：請確保將壓脈帶接頭確實插入本產品的壓脈帶插座，要聽到明顯的“喀”聲響才是確實安裝緊密。**
<Err5>	異常的結果	因測量訊號不正確而無法顯示結果。請詳讀並執行有效測量的要點，然後再測量一次。*
<Err6>	M A M 模式	MAM 模式下測量出現太多錯誤訊息，因此無法演算出可信任的最終結果。請詳讀並執行有效測量的要點，然後再測量一次。*
<HI>	脈搏或壓脈帶壓力過高	壓脈帶的壓力過高 (超過 299mmHg) 或脈搏過高 (每分鐘超過 ≧ 199 次)。請休息 5 分鐘後再測量一次。
<LO>	脈搏過低	脈搏過低 (每分鐘不到 < 30 次)。請再測量一次。
ᛒ	藍牙符號 ⑮ 快速閃爍	如果藍牙連接錯誤，關閉裝置藍牙並關閉智慧型手機上的應用程式。等待 1 分鐘，打開智慧型手機上的應用程式並手動啟動裝置上的藍牙，以重試藍牙連接和資料傳輸。

<ERR bt>	藍牙自檢錯誤	藍牙故障。請聯絡您當地的原廠經銷商。

* 若以上任一情況持續發生，請諮詢醫師。

11. 安全性維護、準確度測試和丟棄處置

⚠ 安全與保護

- *請依照指示操作本產品。本說明書提供關於本產品重要的操作及安全資訊。請在使用前詳閱本說明書，並且妥善保存。*
- *本產品僅可依照說明書所描述之用途使用，因不當使用造成的任何損害，製造業者概不負責。*
- *本產品內含精密元件，必須謹慎處理。存放和操作條件請遵照“技術規格”章節中的說明。*

請勿讓本產品：

- *接觸水或受潮*
- *暴露在極端溫度下*
- *受到撞擊或摔落*
- *沾染灰塵*
- *受到陽光直射*
- *處於過冷或過熱環境*

- *壓脈帶結構精密，必須謹慎處理。*
- *請勿使用非本產品專用的壓脈帶或是接頭。*
- *裝上壓脈帶後才可充氣。*
- *勿將本產品靠近手機或無線電等強烈電磁場。 使用時請對上述儀器設備至少保持 3.3m 的距離。*
- *若發覺本產品損壞或發生不正常， 請勿再使用本產品。*
- *請勿企圖拆開本產品。*
- *久置本產品不用時應先取出電池。*
- *請詳讀手冊內各章節的詳細安全說明。*
- *本產品的測量結果無法作為診斷使用。測量結果不能用來取代醫師的諮詢判斷，尤其是結果與使用者病徵不符合時。不能只仰賴本產品測量結果，請注意其他潛在的病徵及使用者主觀的反饋。如果有需要，請通知醫師或救護車。*
- *長期的高血壓可能破壞您的身體健康，請諮詢醫師的協助。*
- *請與您的醫師討論測量結果，如果您發現任何不尋常或不確定的徵兆，請讓醫師知道。不要僅仰賴單次血壓量測的結果。*
- *在諮詢醫師之前，不要隨意自行變更您使用藥物的劑量，或是開始任何療程。*
- *由於量測當下的情境完全不同，由醫師、藥局及在家測量的血壓值出*

現偏差值是正常的。

- *脈搏的測量無法用於確認心臟起搏器的頻率！*
- *如果您懷孕了，建議您定期監測您的血壓，懷孕期間血壓變化較大。*

請勿讓兒童擅自使用本產品；有些小零件會造成吞食的危險。本產品含有長條線狀配備，請注意不要讓兒童被線狀配備纏繞而造成窒息。

儀器保養
請以乾軟的布擦拭本產品。

清潔壓脈帶
請小心以濕布沾肥皂水擦拭清除髒汙，並在陰涼處自然風乾。

⚠ 警告 : 無論在任何情況下都不得清洗 " 壓脈帶 "。

準確度測試
我們建議本產品每兩年或機體受到撞擊 (如摔落) 後需進行一次準確度的測試。如需校正， 請洽詢 Microlife 維修中心安排測試 (請參閱前言)。

丟棄處置

丟棄電池或電器時需遵照當地的相關法規 (不包括家居廢物)。

12. 保固

本產品具有 3 年保固 (自購買日算起)。保固效力需憑經銷商認可並含購買日期和收據的保證卡。

- 保固不含電池。
- 壓脈帶保固期為 1 年。
- 任意打開或拆裝本產品，將使保固無效。
- 保固不含因不當處理、電池放電、意外情形或未遵照操作說明而導致的儀器損壞。

保固服務請洽詢 Microlife 總代理商 (請參閱前言)。

13. 技術規格

- 操作環境：溫度 10°C~40°C/50-104°F; 15%~90% 最大相對濕度
- 儲存溫度：溫度 -20~+55°C/-4~+131°F; 15~90% 最大相對濕度
- 重量：415g (包含電池)
- 機體尺寸 (mm) ：157.5 (長) x 105 (寬) x61.5 (高)
- 測量方法：振幅探測法 (第一相為收

縮壓、第五相為舒張壓)
- 測量範圍：收縮壓 60~255 mmHg；舒張壓 40~200 mmHg
- 脈搏 (每分鐘) 30~199 次數 / 分鐘
- 壓脈帶壓力顯示範圍 : 0 - 299 mmHg
- 解析度：1mmHg
- 靜態壓力準確度 : 壓力於 ± 3 mmHg 之間
- 脈搏準確度 : ± 5 % 的測量值
- 無線通訊：低功率藍牙
- 電源：4 顆 1.5V AA 鹼性電池；
  變壓器：
  DC 6V, 600 mA(選購品)
- 電池壽命：大約 920 次量測 (使用新電池)
- 防水等級：IP21 (防止直徑大於 12.5mm 的固體外物完全侵入箱體內，防護垂直落下的水滴引起的損害。)
- 機台預期使用壽命 : 5 年或是 10000 次量測 (不含配件), 配件 : 2 年
- 無線通訊：Bluetooth Smart
  -App「Microlife Connected Health+」(限血壓計模式下)
  - Android 版本 3.3.4
  - iOS 版本 1.39
  - 行動裝置作業系統：Android 5.0 以上 / iOS 10 以上
  - 功能：傳輸 / 檢閱 / 保存 血壓資料

符合NCC 電信法的認證符號。
型號: BP3KV1-5B (BP B6 Advanced Connect)
證號: CCAM26LP0370T8

無線設備警告聲明

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

總代理：泰豐生技股份有限公司
服務電話：02-6635-8789
服務時間：上午8:30~下午5:30
地址：241 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓

醫療器材商名稱：
百略醫學科技股份有限公司
醫療器材商地址：
台北市內湖區瑞光路431號9樓
製造業者名稱 /地址：Manufactured by ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (地址：No.138, Huasheng Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China) for UAB “Microlife” (地址：P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, Lithuania)

版本:0726